


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2019г.

____/____2019г.



*Паспорт контактирующего устройства
ТК-сl-p-2x6-20.0-004
(Диоды 2Д102А, Д237И-Н, 2Д419В, 2Д510А, 2Д522Б, 2Д922А)*

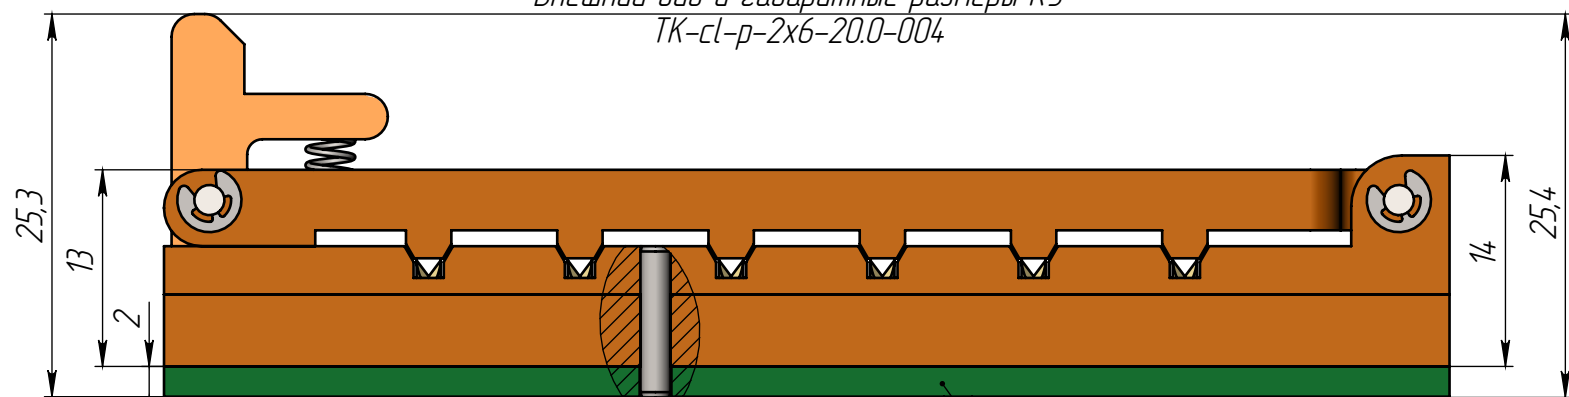


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 6.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 2$ мм. Количество штифтов – 2 шт.
- × Крепеж для фиксации КУ на печатной плате включен в комплект поставки.

Печатная плата


Крепление КУ
к печатной плате

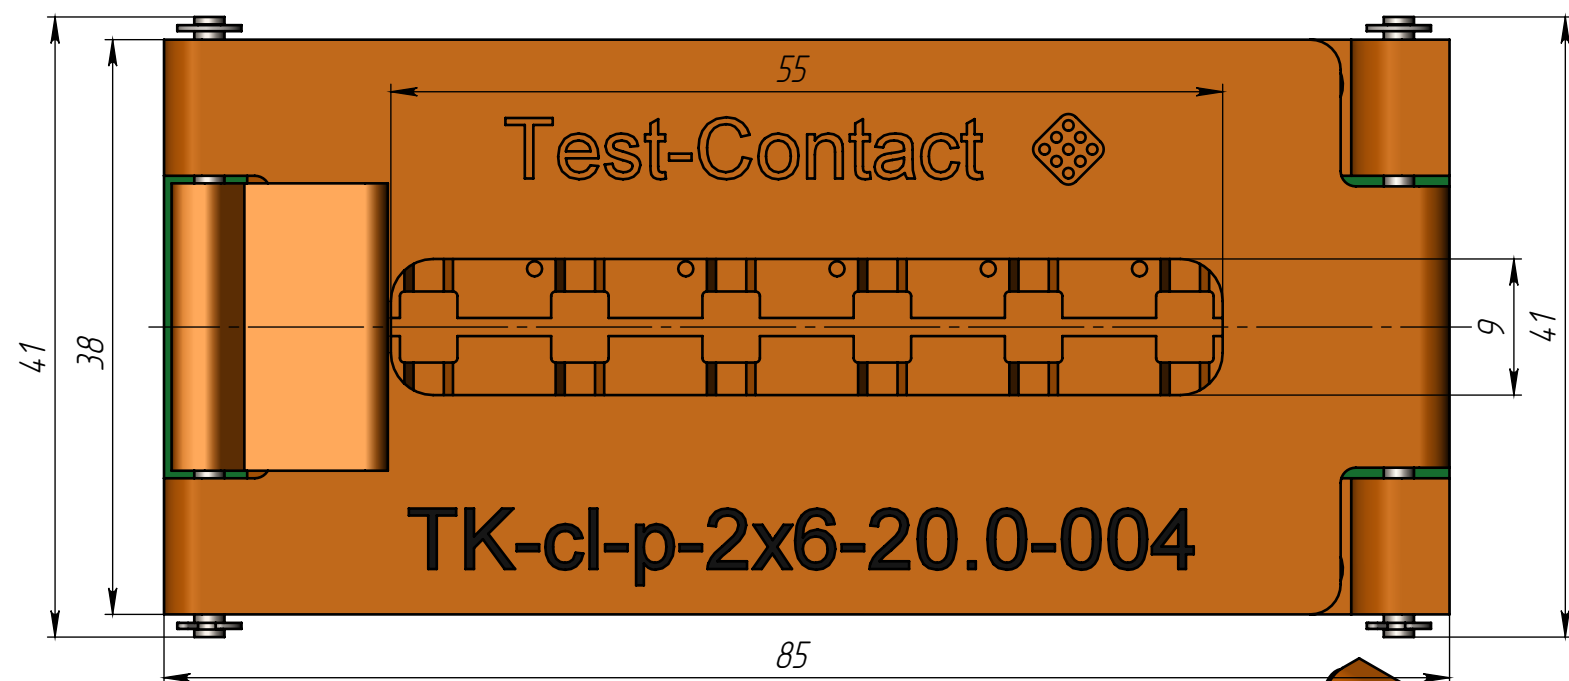


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 6
- × Количество выводов КУ, шт. – 24
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 2,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1

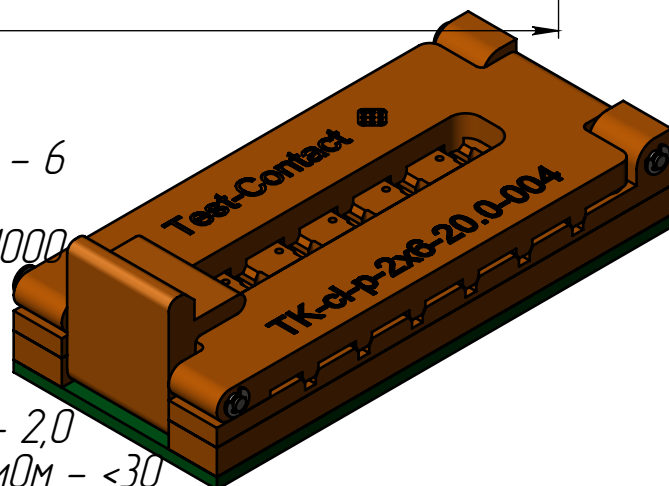

Посадочное место КУ

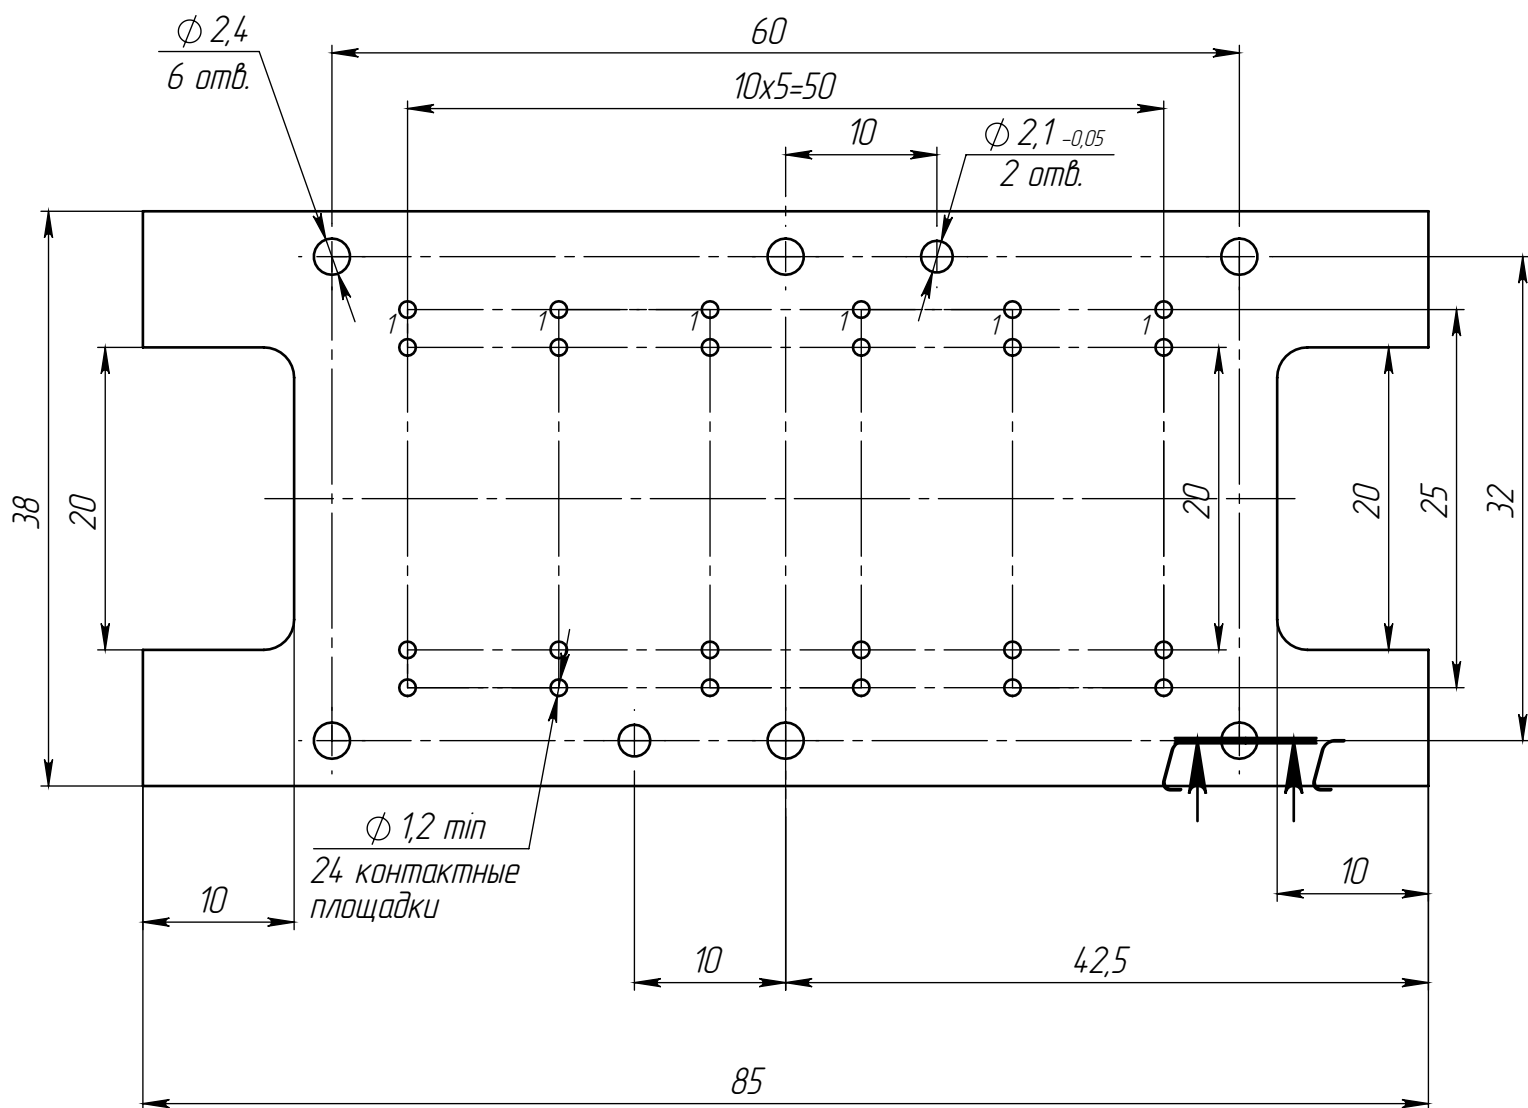
Вид на устройство сверху

C-C (2 : 1)




1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.


Место установки ЭРИ

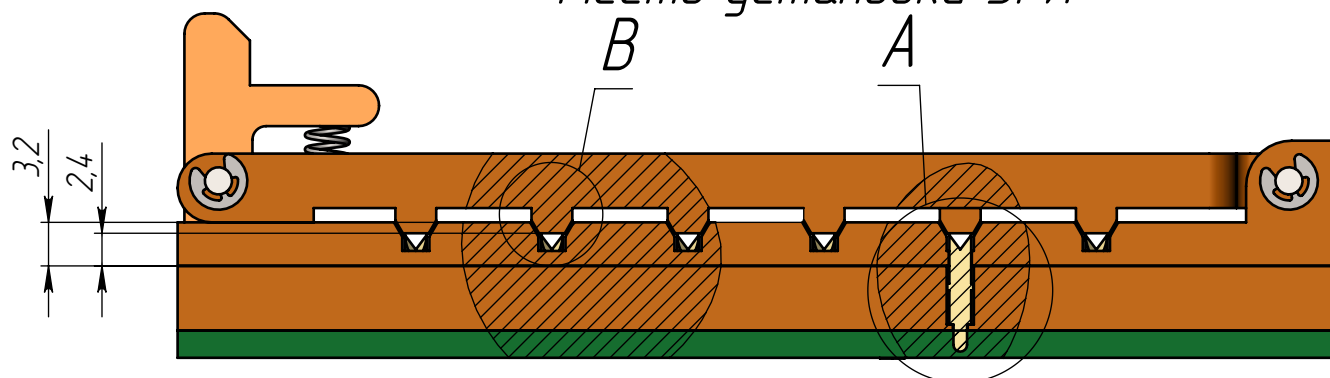


B (4 : 1)

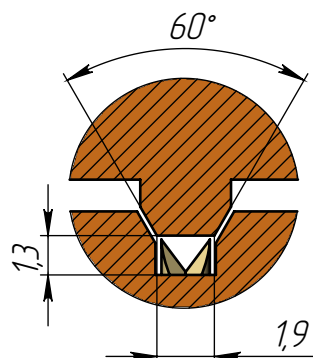


A (4 : 1)

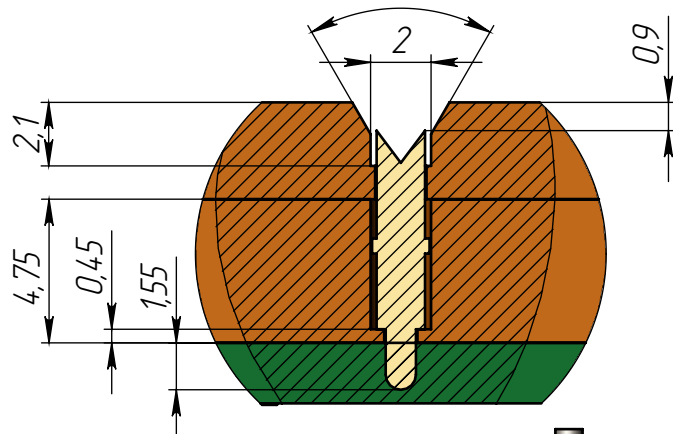

Место ориентации

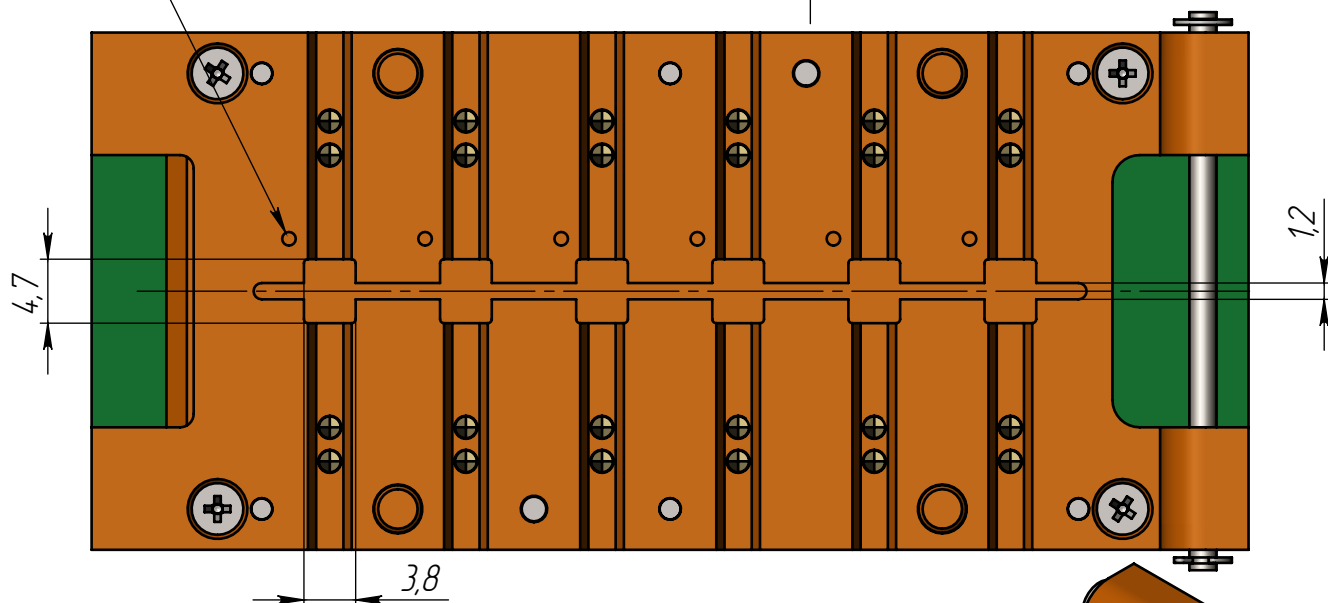


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

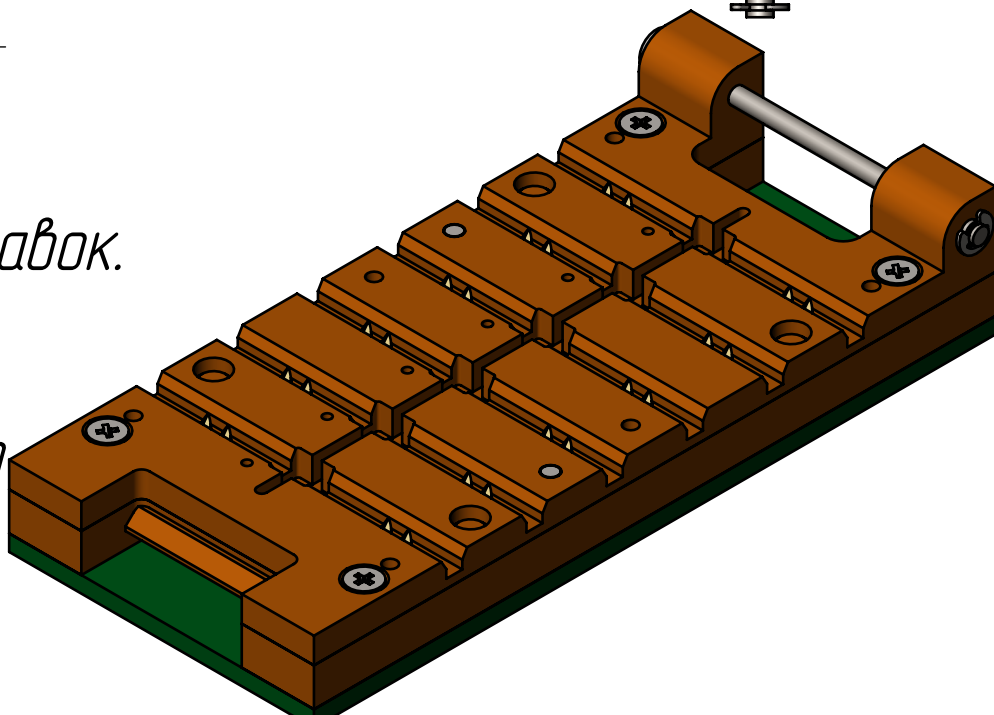


Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

2Д102А

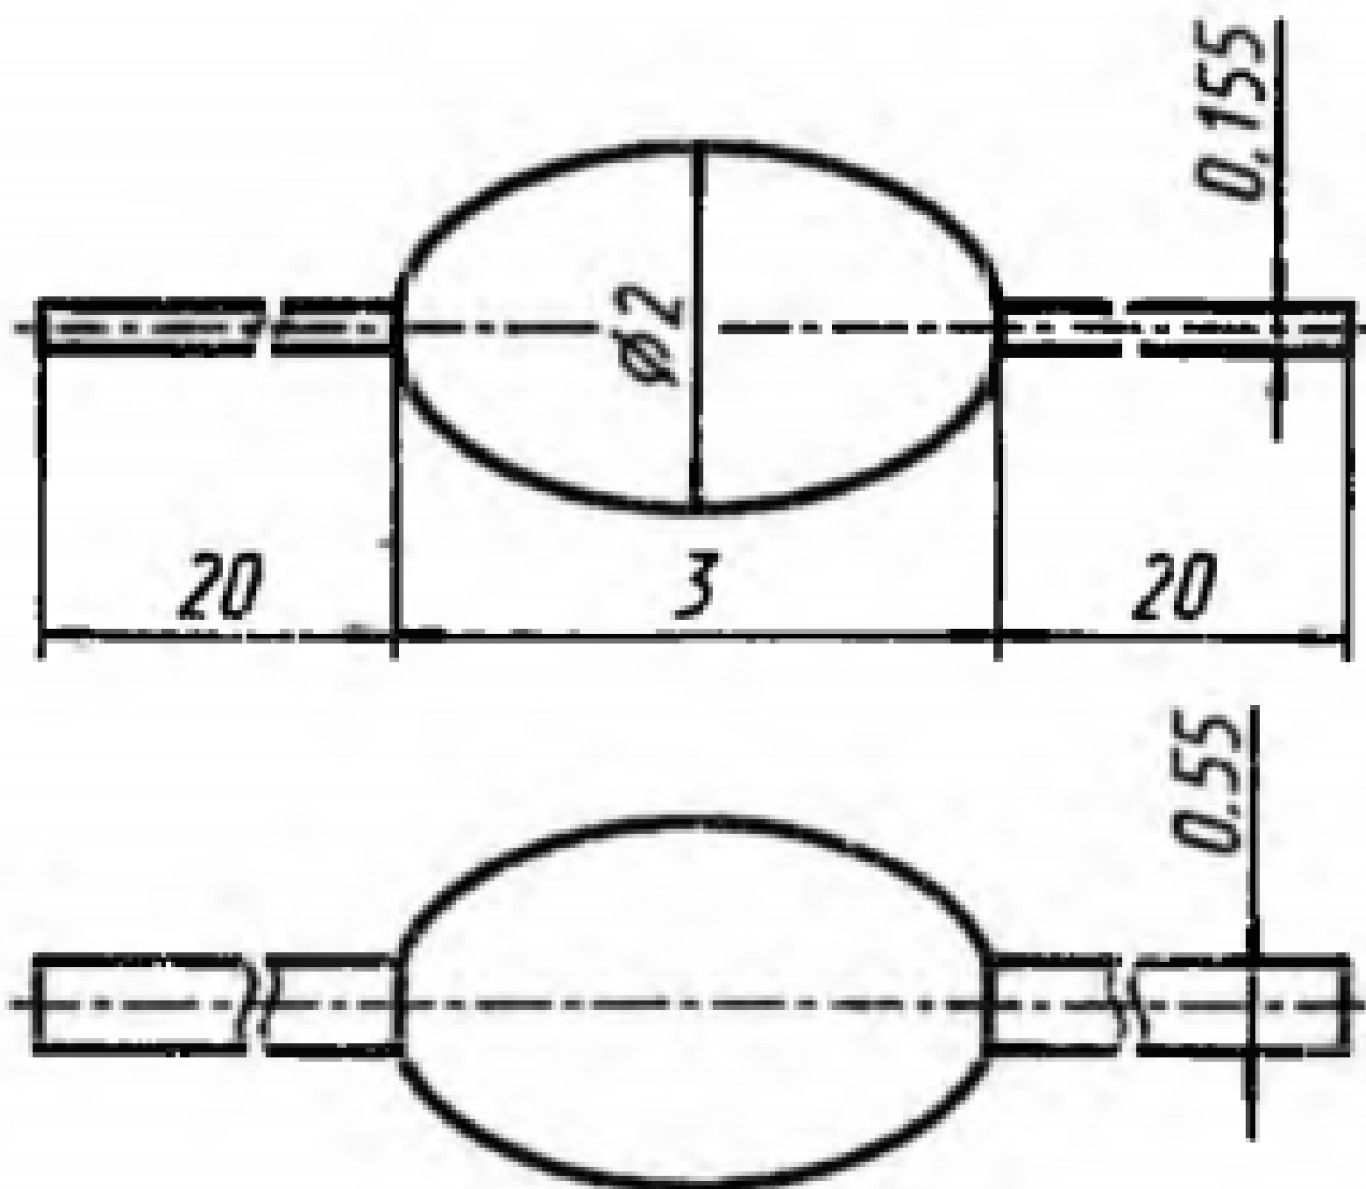


Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

2Д419В

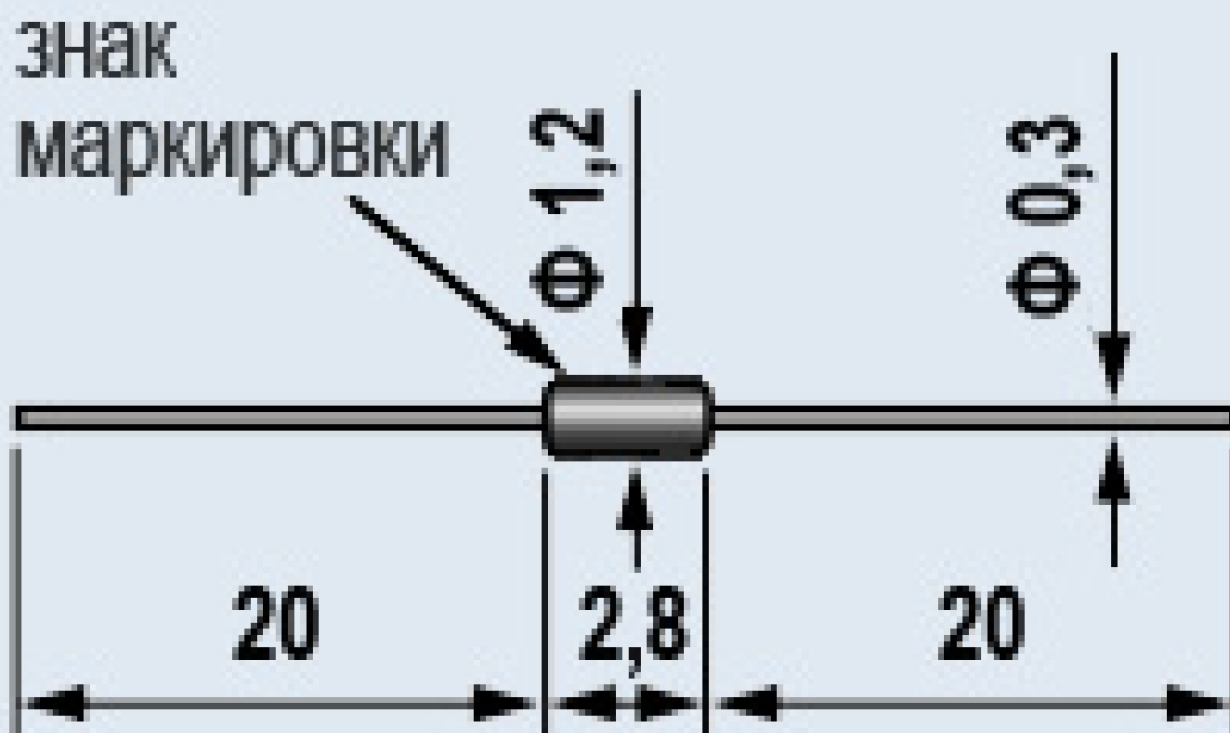


2Д510А

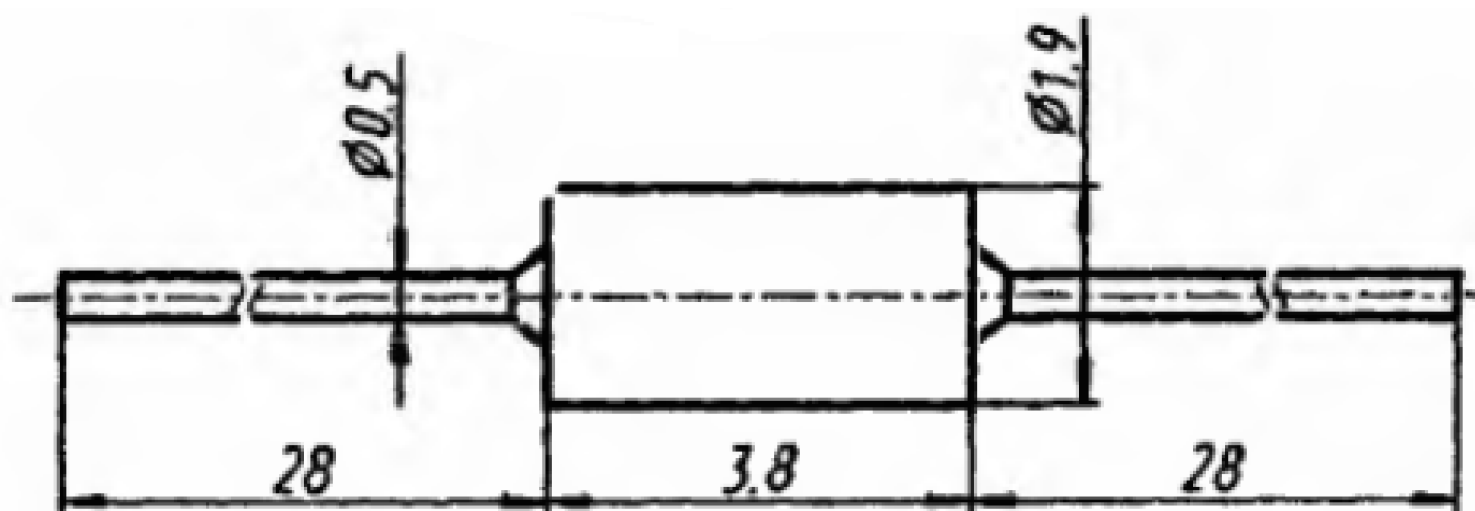


Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

2Д522Б

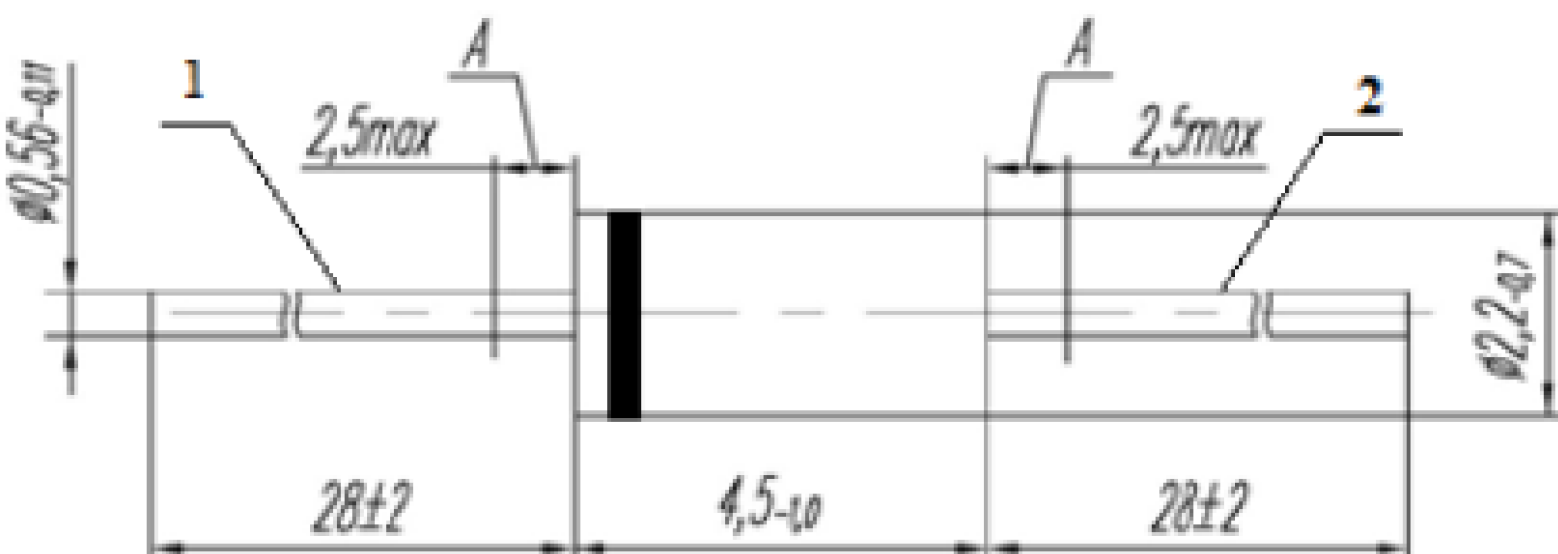


2Д922А

знак
маркировки

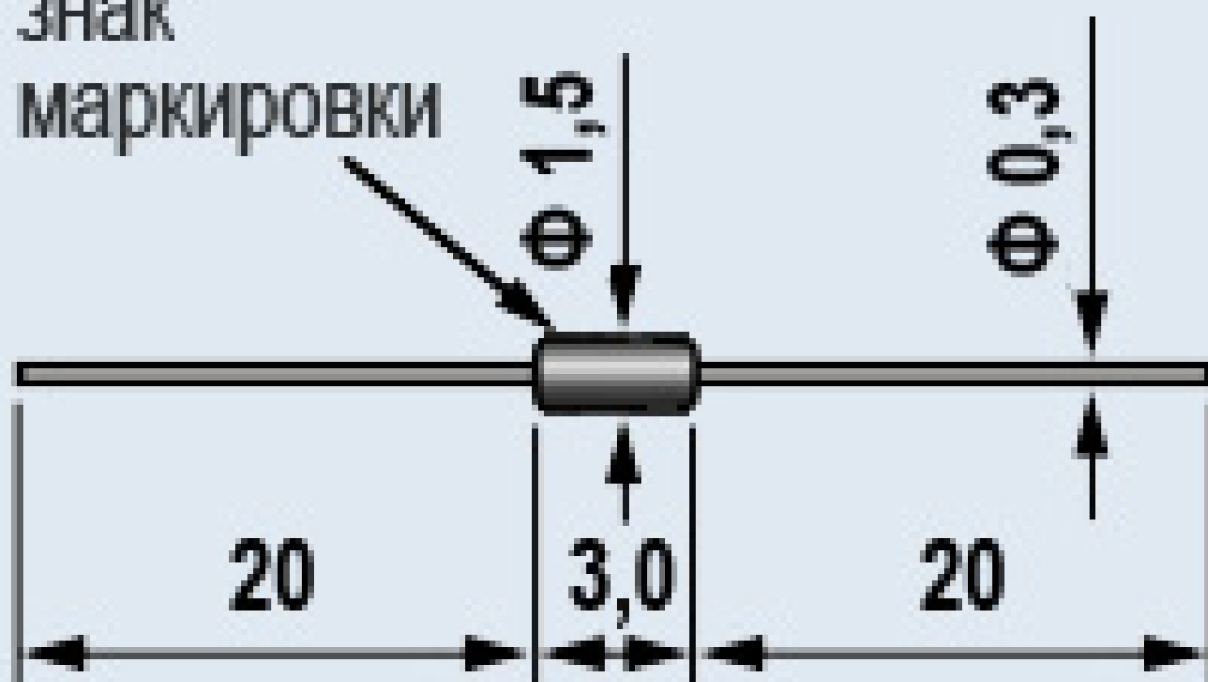

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

Д237И-Н

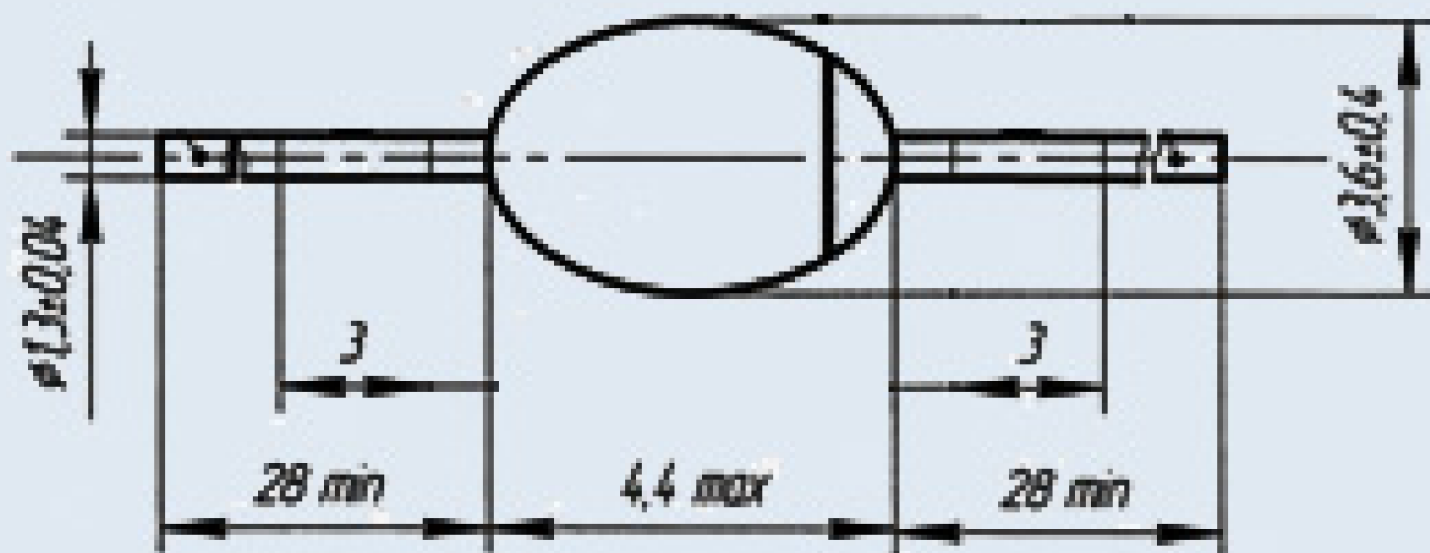

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Свидетельство о приёмке

Производитель: ООО "Тест-Контакт"

Юридический адрес: 109316, г. Москва, проспект Волгоградский, дом. 42, к. 5, эт. 1 пом. I ком.100А

Фактический адрес: 111024, Москва г, Кабельная 2-я ул, дом 2, строение 1 и 3

Гарантийный срок на поставляемые КУ ТК-сl-р-2х6-20.0-004 – 15 месяцев с даты изготовления или 10 000 контактирований при соблюдении условий эксплуатации.

Дата изготовления: июнь 2019 г.

Количество принятой продукции: _____ шт.

Дата приёмки

____/____2019г.

Подпись ОТК
